

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)57-20-16

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

[https://khromos.nt-rt.ru/ || hmc@nt-rt.ru](https://khromos.nt-rt.ru/)

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Хроматографы газовые промышленные «Хромос ПГХ-1000.1»

Назначение средства измерений

Хроматографы газовые промышленные «Хромос ПГХ-1000.1» (далее - хроматографы) предназначены для измерения содержания компонентов, входящих в состав анализируемых проб веществ и материалов.

Описание средства измерений

Принцип действия хроматографа основан на разделении на хроматографических колонках вследствие различного распределения компонентов пробы между неподвижной фазой и подвижной фазой - газом-носителем с последующим детектированием компонентов анализируемой пробы.

Хроматограф состоит из следующих блоков:

- блок управления – вычислительное устройство на базе РС/АТ совместимого компьютера с установленным программным обеспечением «Хромос». Вычислительное устройство работает совместно с центральной платой управления, которая обеспечивает связь между хроматографом и встроенным компьютером;

- программное обеспечение «Хромос» (далее - ПО) - для управления хроматографом, а также сбора и обработки хроматографических данных.

- блок аналитический.

В состав аналитического блока входят:

- один или два термостата, теплоизолированных съёмных;
- нагреватели (для поддержания температуры термостата);
- хроматографические колонки;
- дозирующие краны;
- переключающие клапаны;
- усилители;
- платы управления клапанами и платы питания;
- пневмосопротивления;
- регуляторы потока газов.

На передней панели прибора имеется дисплей, предназначенный для управления прибором и отображения информации.

В приборе могут быть установлены капиллярные, насадочные и микронасадочные колонки. В зависимости от решаемой аналитической задачи, приборы могут быть оснащены одним или несколькими детекторами из следующего списка:

- ДТП – детектор по теплопроводности;
- ПИД – пламенно-ионизационный детектор;
- ПФД-S – пламенно-фотометрический детектор;
- ТХД – термохимический детектор.

Градуировка хроматографа проходит в автоматическом режиме.

Хроматографы газовые промышленные «Хромос ПГХ-1000.1» выпускаются в двух исполнениях.

В исполнении 1 хроматограф выполняется в специальном взрывозащищенном исполнении в корпусе с непроницаемой оболочкой «d» по ГОСТ ИЕС 60079-1-2011. Хроматограф в исполнении 1 может быть укомплектован одним или несколькими детекторами по теплопроводности и термохимическим детектором.




Исполнение 1



Исполнение 2

Рисунок 1- Внешний вид хроматографа газового промышленного «Хромос ПГХ-1000.1»

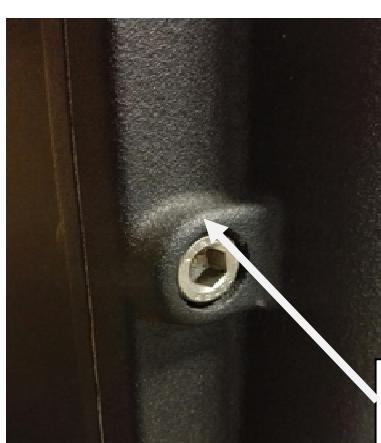

Место нанесения
знака поверки

Исполнение 1



Исполнение 2

Рисунок 2 - Место пломбировки хроматографа газового промышленного «Хромос ПГХ-1000.1» от несанкционированного доступа и нанесения знака поверки в виде оттиска поверительного клейма

В исполнении 2 конструкция хроматографа выполняется в специальном взрывозащищеннем исполнении - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р» по ГОСТ IEC 60079-2-2013. Повышенная защита «е» по ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006 обеспечивается продувкой блока электроники и детекторов хроматографа воздухом КИП под избыточным давлением. Хроматограф в исполнении 2 может быть укомплектован детекторами по теплопроводности, пламенно-ионизационным детектором, пламенно-фотометрическим детектором, и термохимическим детектором.

Программное обеспечение

Для управления работой хроматографа, сбора и обработки хроматографических данных, ведения базы данных по хроматографическим анализам используется программное обеспечение «Хромос».

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1- Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование программного обеспечения	CalcModule.dll
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	1.2
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	37C2B7AB
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного кода	CRC-32

Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики отсутствует.

Метрологические характеристики хроматографа нормированы с учетом программного обеспечения.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2- Пределы допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения (ОСКО) выходного сигнала (площади, времени удерживания) в изотермическом режиме

Детектор	ОСКО по времени удерживания, %	ОСКО по площади, %		
		дозирование газа	дозирование жидкости	
			насадочная колонка	капиллярная колонка
ПИД	1	1	2	4
ДТП	1	1	2	-
ПФД-S	1	3	-	-
ТХД	1	2	-	-

Таблица 3-Дополнительные метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемого значения относительного изменения выходного сигнала (площадей) от первоначального значения за 48 ч непрерывной работы, %	
- ПИД, ДТП	± 5
- ПФД-S, ТХД	± 10
Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала детекторов:	
- ПИД, А, не более	$2,0 \cdot 10^{-14}$
- ДТП, В, не более	$1,6 \cdot 10^{-7}$
- ПФД-S, А, не более	$5,0 \cdot 10^{-12}$
- ТХД, В, не более	$1,0 \cdot 10^{-5}$
Уровень дрейфа нулевого сигнала детекторов	
- ПИД, А/ч, не более	$5,0 \cdot 10^{-12}$
- ДТП, В/ч, не более	$1,0 \cdot 10^{-4}$
- ПФД-S, А/ч, не более	$1,0 \cdot 10^{-10}$
- ТХД, В/ч, не более	$1,0 \cdot 10^{-4}$
Пределы детектирования детекторов:	
- ПИД, по гептану, бензолу или пропану, гС/с, не более	$4,0 \cdot 10^{-12}$
- ДТП, гептану, пропану, азоту, водороду г/см ³ , не более	$3,0 \cdot 10^{-9}$

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	Значение
- ПФД-С, по сере в сероводороде, г/с, не более	$4,0 \cdot 10^{-12}$
- ТХД, по кислороду, г/см ³ , не более	$1,5 \cdot 10^{-10}$

Таблица 4- Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Температура термостата колонок, °C	от (Токр+3) до +300
Температура термостатируемых зон, °C	от +40 до +300
Максимальная температура дозатора, °C	+300
Максимальная температура кранов, °C	+300
Максимальная температура детекторов, °C:	+300
Дискретность задания температур во всех зонах, °C	0,01
Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения, °C	±5
Параметры электрического питания:	
- напряжение переменного тока, В	230 ± 23
- частота переменного тока, Гц	$50 \pm 0,1$
- напряжение постоянного тока, В	24 ± 3
Конфигурация хроматографа:	
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более:	
- Исполнение 1 (моноблок)	$250 \times 400 \times 600$
- Исполнение 2 (состоит из нескольких блоков)	$660 \times 350 \times 1010$
Наработка на отказ, ч, не менее	26280
Средний срок службы, лет	10
Масса (без системы пробоподготовки), кг, не более:	
- Исполнение 1	50
- Исполнение 2	80
Мощность, потребляемая хроматографом (без дополнительных устройств), В·А, не более:	
Исполнение 1: при выходе на рабочий режим	450
Исполнение 2: при выходе на рабочий режим	2200
Исполнение 1: после выхода на рабочий режим	80
Исполнение 2: после выхода на рабочий режим	1000
Время выхода на режим, час, не более	1,5
Передача данных	Ethernet (Modbus TCP), RS-485 (Modbus RTU), Аналоговый выход от 0 до 20 мА Аналоговый выход от 4 до 20 мА Аналоговый выход от 0 до 5 В Аналоговый выход от 0 до 10 В Аналоговый выход от - 5 до + 5 В Аналоговый выход от - 10 до + 10 В Дискретные выходы (сухой контакт)
Маркировка взрывозащиты:	
- Исполнение 1	1Ex d ib [ib IIIC] IIB T4 Gb X
- Исполнение 2	1Ex d e px ib IIIC T2 Gb X
Подгруппа электрооборудования по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	IIIC

Продолжение таблицы

Наименование характеристики	Значение
Температурный класс: - Исполнение 1 - Исполнение 2	T4 T2
Применимый тип взрывозащиты: - Исполнение 1 - взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ IEC 60079-1-2011 - Исполнение 2 - оболочка под избыточным давлением по ГОСТ IEC 60079-2-2013 - повышенная защита по ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006 - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением. Ex-атмосфера изолирована от источника возгорания по ГОСТ IEC 60079-2-2013	d p e px
Степень защиты от воздействия окружающей среды хроматографа по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP65
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от +4 до +50 от 30 до 80 от 84 до 106

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на правую панель корпуса хроматографа в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность хроматографов

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Хроматограф газовый промышленный «Хромос ПГХ-1000.1»: Исполнение 1 Исполнение 2	-	1
Паспорт	ХАС 2.320.006 ПС	1
Руководство по эксплуатации	ХАС 2.320.006 РЭ	1
Методика поверки	ХАС 2.320.006.01 МП	1
Руководство пользователя программой «Хромос»	-	1
Копия сертификата соответствия требованиям по взрывозащите хроматографа	-	1
Копия свидетельства об утверждении типа средства измерения	-	1
Комплект ЗИП	-	1

Проверка

осуществляется по документу ХАС 2.320.006.01 МП «Хроматографы газовые промышленные «Хромос ПГХ-1000.1». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 28 ноября 2018 г.

Основные средства поверки:

- СО состава газовой смеси пропан-азот ГСО 10651-2015, объемная доля пропана от 0,1 до 0,5 % об. д.;

- CO состава газовой смеси пропан-гелий ГСО 10655-2015, объемная доля пропана от 0,1 до 0,5 % об. д.;
 - CO состава сероводород-азот ГСО 10537-2014, массовая концентрация сероводорода от 9 до 13 мг/м³;
 - CO состава сероводород-метан ГСО 10538-2014, массовая концентрация сероводорода от 4 до 20 мг/м³;
 - CO состава водород-азот ГСО 10532-2014, объемная доля водорода от 0,6 до 1,0 % об. д.;
 - CO состава газовой смеси азот-гелий ГСО 10532-2014, объемная доля азота от 0,1 до 0,5 % об. д.;
 - Гептан эталонный ГОСТ 25828-83, массовая доля основного вещества не менее 99 %;
 - CO состава газовой смеси кислород- аргон ГСО 10611-2015, массовая доля кислорода от 0,01 до 0,02 %;
 - Бензол х.ч. по ГСО 7141-95, массовая доля основного вещества не менее 99,4%;
 - Весы лабораторные электронные МЕ 235 S (рег.№ 21464-07)
- Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
- Знак поверки наносится на крепежный винт крышки (исполнение 1) и на верхнюю переднюю дверку (исполнение 2).

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к хроматографам газовым промышленным «Хромос ПГХ-1000.1»

ГОСТ 26703-93 Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ТУ 4215-006-69502896-18. Хроматографы газовые промышленные «Хромос ПГХ-1000.1».

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (9412)22-21-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93